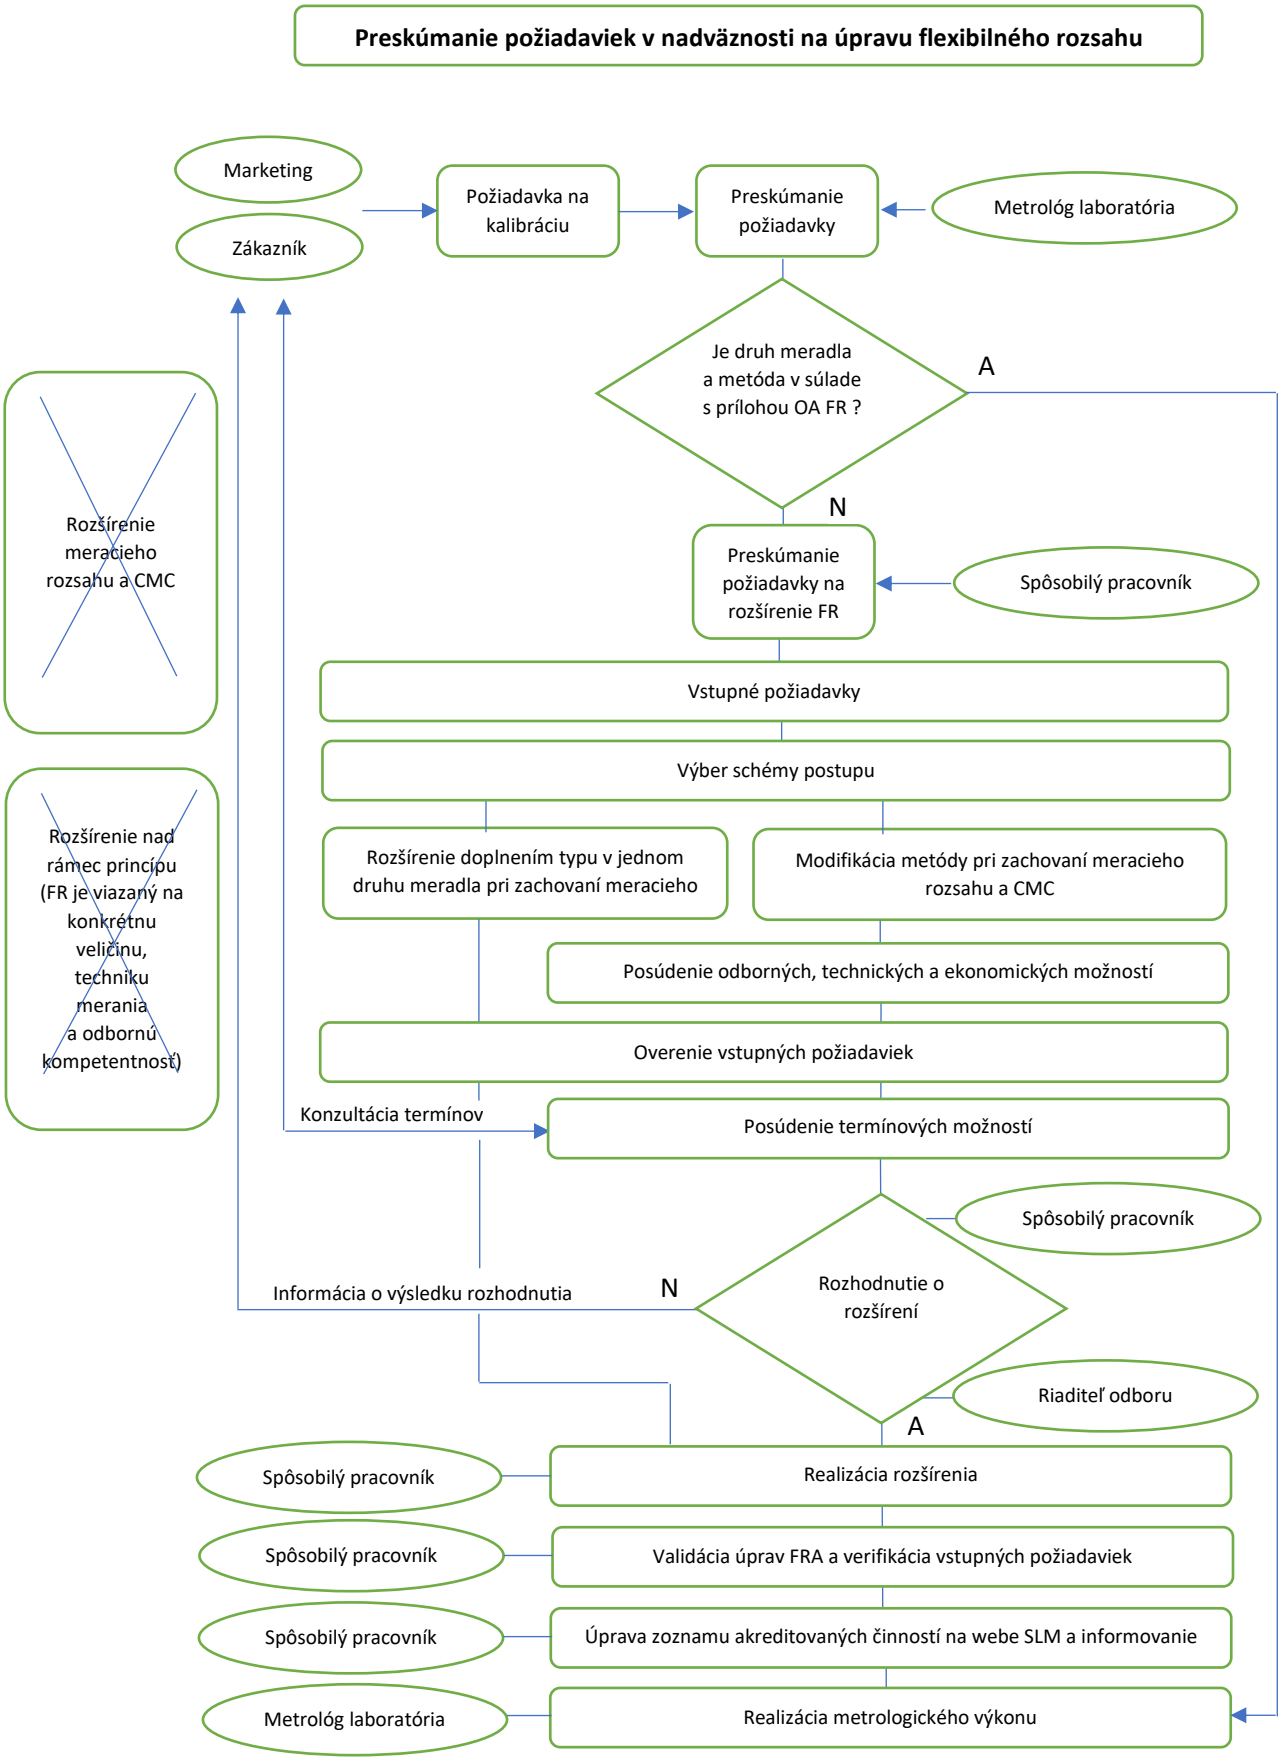
Preskúmanie požiadaviek v nadväznosti na úpravu flexibilného rozsahu
Marketing
Zákazník
Požiadavka na kalibráciu
Preskúmanie požiadavky
Metrológ laboratória
Je druh meradla a metóda v súlade s prílohou OA FR ?
A
N
Preskúmanie požiadavky na rozšírenie FR
Spôsobilý pracovník
Rozšírenie meracieho rozsahu a CMC
Rozšírenie nad rámec princípu (FR je viazaný na konkrétnu veličinu, techniku merania a odbornú kompetentnosť)
Vstupné požiadavky
Výber schémy postupu
Rozšírenie doplnením typu v jednom druhu meradla pri zachovaní meracieho
Modifikácia metódy pri zachovaní meracieho rozsahu a CMC
Posúdenie odborných, technických a ekonomických možností
Overenie vstupných požiadaviek
Konzultácia termínov
Posúdenie termínových možností
Spôsobilý pracovník
Informácia o výsledku rozhodnutia
N
Rozhodnutie o rozšírení
Riaditeľ odboru
A
Spôsobilý pracovník
Realizácia rozšírenia
Spôsobilý pracovník
Validácia úprav FRA a verifikácia vstupných požiadaviek
Spôsobilý pracovník
Úprava zoznamu akreditovaných činností na webe SLM a informovanie
Metrológ laboratória
Realizácia metrologického výkonu